

# トライロック

# NISHI

## 取扱説明書

## 品番：KS1015

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

### ⚠️ 注意すること

- ご使用前にサイズが合っているか確認してください。
- 汗や摩擦などにより、色落ちやほかの生地に色移りすることがあります。
- ご使用中にズレたときは、正しい手順で最初から装着し直してください。
- 面ファスナーがほかの衣類に付かないようにしてください。ほつれや伝線の原因になります。

### ⊘ してはいけないこと

- 本品を装着したまま車両などを運転しないでください。運転操作に支障が出る恐れがあります。
- 本品の分解、改造は決して行わないでください。
- 屋外、高温、多湿、直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所には保管しないでください。
- アレルギー体質の方や、皮膚が過敏な方、装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある方は使用しないでください。
- 装着したまま就寝しないでください。長時間の圧迫などによる皮膚障害や血行障害などになる恐れがあります。
- 必要以上にきつく締め付けしないでください。
- 面ファスナーの付きが悪くなった場合は、使用しないでください。

### ❗️ 必ず行うこと

- 装着は正しく行ってください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

### ■ お手入れの仕方

- 面ファスナーを剥がしたまま洗濯すると、洗濯中にサポーター本体に絡まり傷めてしまうことがあります。洗濯するときは必ず面ファスナーを貼り合わせた状態にしてください。

### ● 洗濯の仕方

- 本品は、洗濯機を使用せず手洗いしてください。
- 洗濯は温水は使用せず水で行ってください。
- 塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。
- 洗濯後はタオルなどで水分を吸収し風通しのよい日陰で乾燥させてください。

### ■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

### ■ はじめに

本品は、バイオスキンの薄さを活かして、シューズを履いたとき、内部での着用時の違和感を軽減する足関節のサポーターです。  
スターアップストラップとプラスチック製ステイにより、足関節の内反・外反予防に効果が期待できます。また、独自のフットロックストラップで足首をコントロール。内反予防におすすめします。  
シューズを履いたままでも、サポート強度の調節が可能です。

### ■ 各部の名称



### ■ 仕様

サイズ：(S) 23～24.5cm、(M) 25～27.5cm、(L) 28～30.5cm  
材 質：両側プラスチック(ステイ内蔵) 左右兼用  
付属品：スターアップストラップ、フットロックストラップ  
メキシコ製  
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

### お問い合わせ



商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。  
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室  
〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号  
TEL: 03-6369-9024



受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00  
(土日、祝日及び弊社都合による休日を除く)  
URL: <http://www.nishi.com/>

■ 装着の仕方


● アンダースリーブの装着

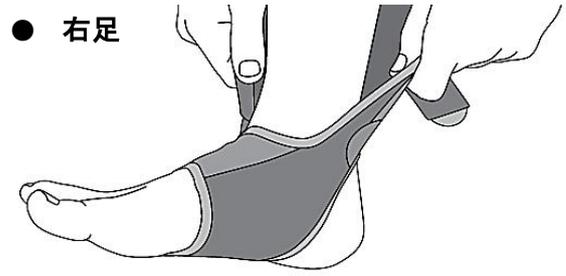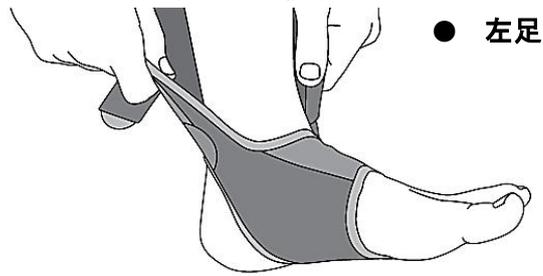

① アンダースリーブを足元に引きます。靴下の上からでも装着できます。

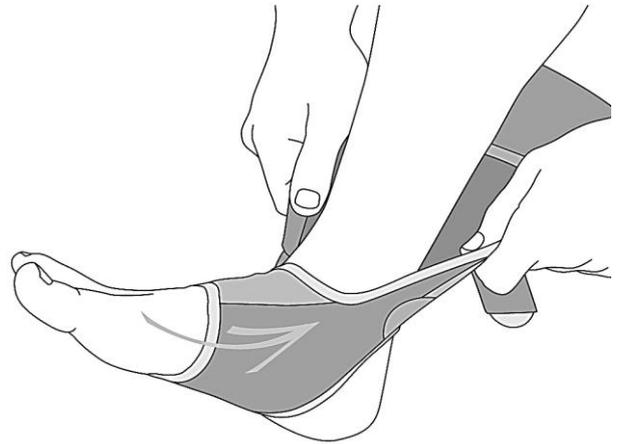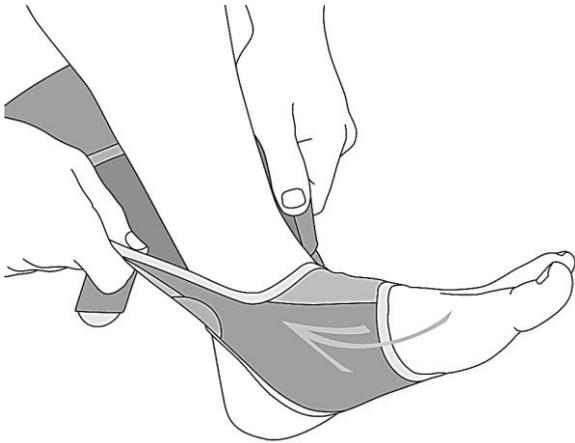


② フリースのフラップを足首に巻きつけます。

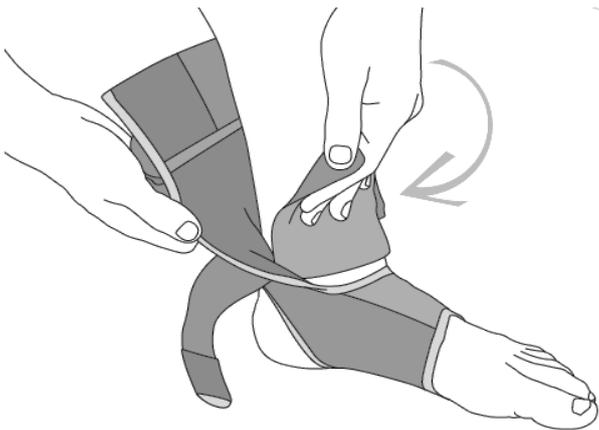

③ 先に上側のストラップをしっかりと貼り付けます。続いて下部のストラップを貼り付けます。



● フットロックストラップ（白色ストラップ）の装着

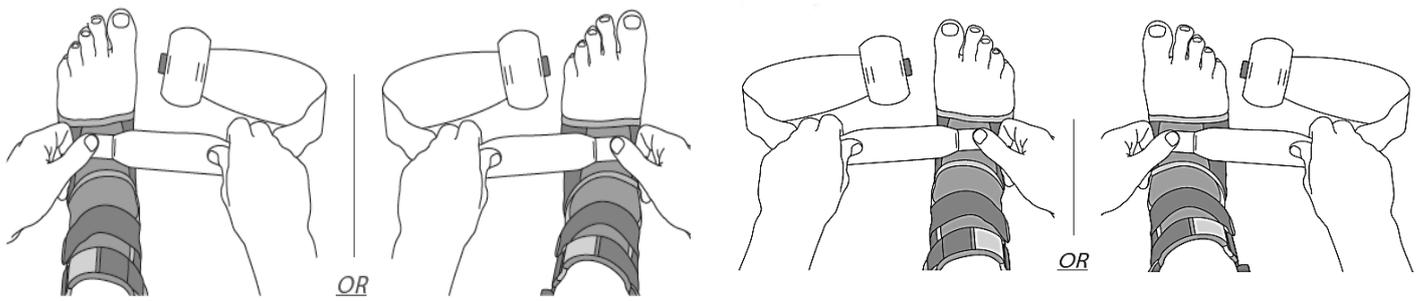


○フットロックストラップの巻き方は症状によって異なります。

Aの場合：足首の捻挫、足首の固定、腓骨腱炎など


Bの場合：アーチサポート（PTTD）、足底筋膜炎、かかとの痛み

A 足首の捻挫、足首の固定、腓骨腱炎など


① 面ファスナーの黒い面を下にして足の甲部に貼り付けます。そのときストラップは足の内側に向いています。

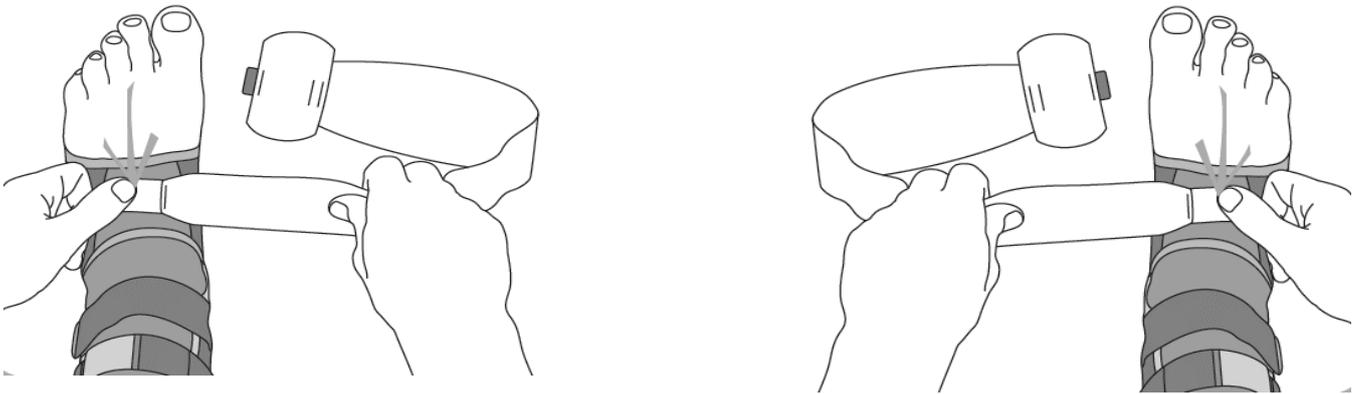

② 足の下にストラップを回し、足を地面に押し付け、ストラップを面ファスナーに押し付けます。

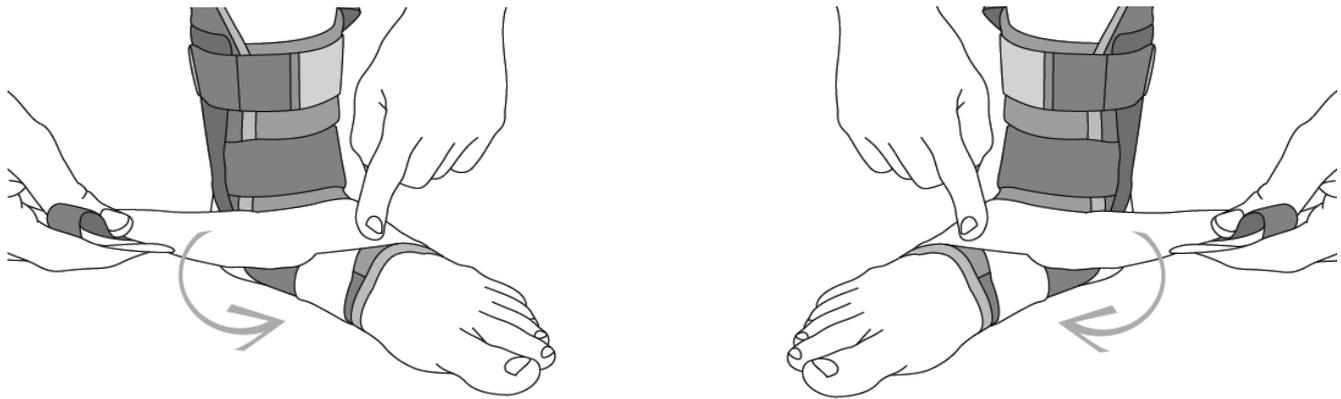


③ ストラップを再び足の下に巻き、面ファスナーのタブを引き、足首の外側の高い位置に貼り付けます。

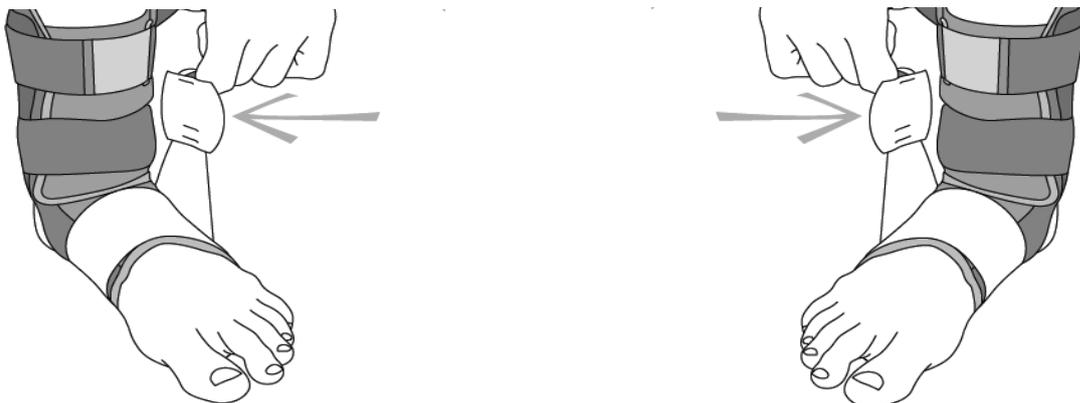


## B アーチサポート (PTTD) 、足底筋膜炎、かかとの痛み


- ① 面ファスナーの黒い面を下にして足の甲部に貼り付けます。そのときストラップは足の外側に向いています。

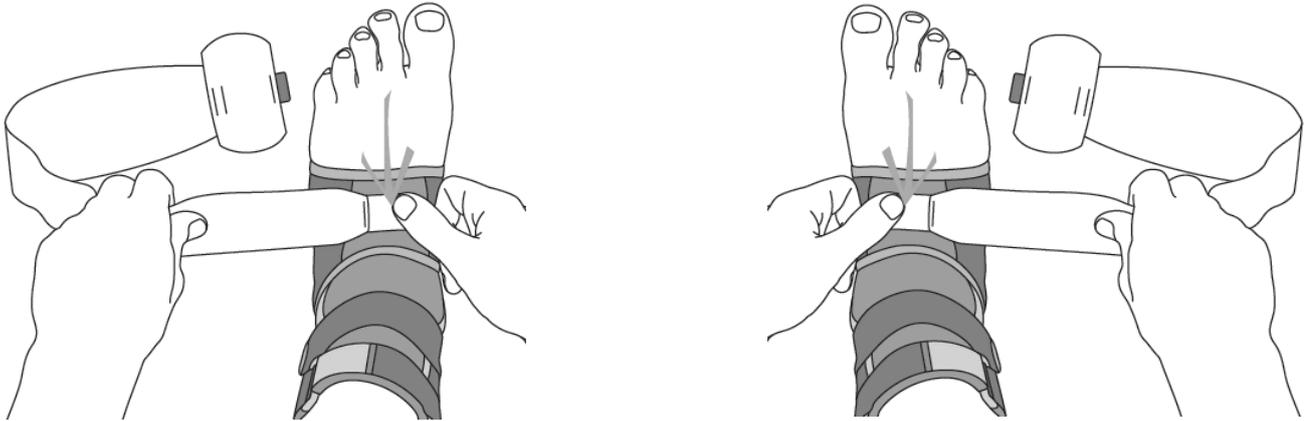



- ② 足の下にストラップを回し、足を地面に押し付け、ストラップを面ファスナーに押し付けます。

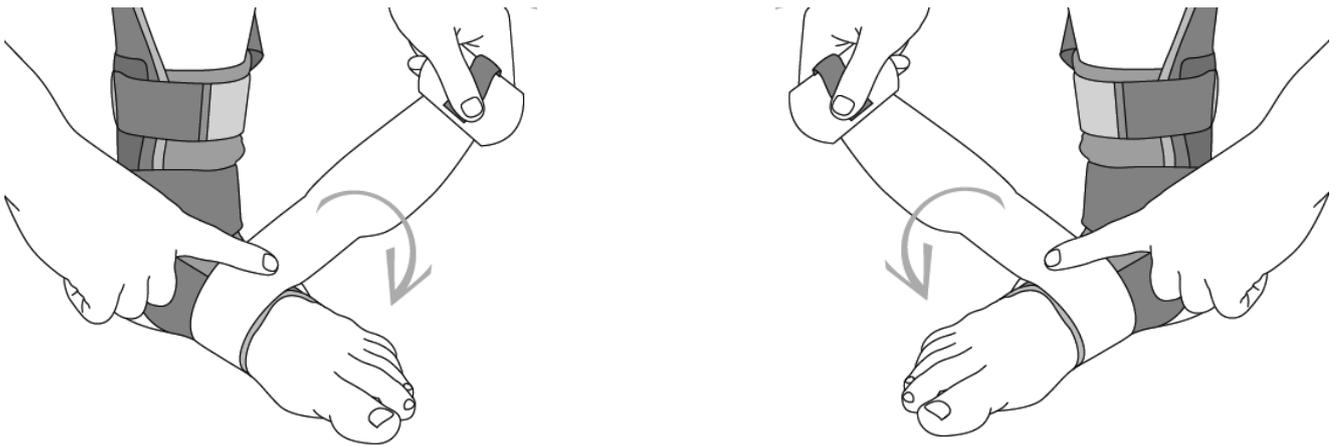



- ③ ストラップを再び足の下に巻き、面ファスナーのタブを引き、足首の外側の高い位置に貼り付けます。

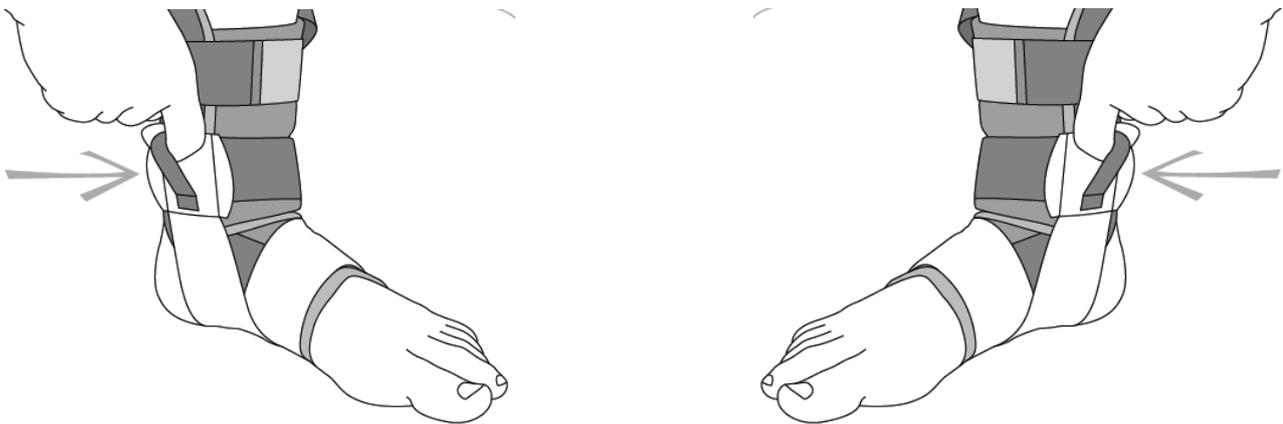



● スターアップストラップ（黒色ストラップ）の装着

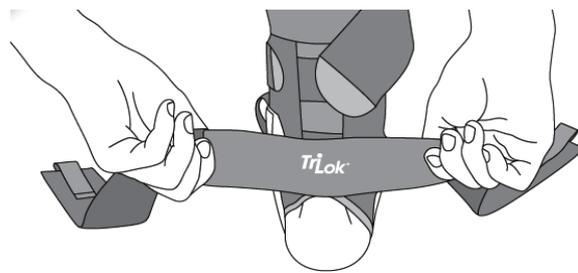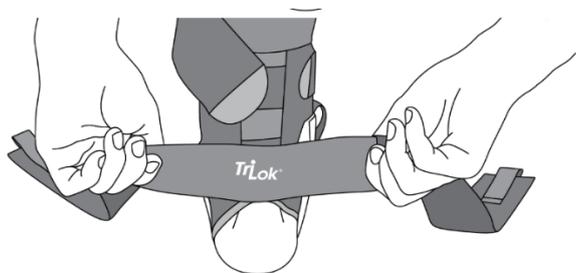


① ストラップの中心にある面ファスナーを足首の後ろに貼り付けます。

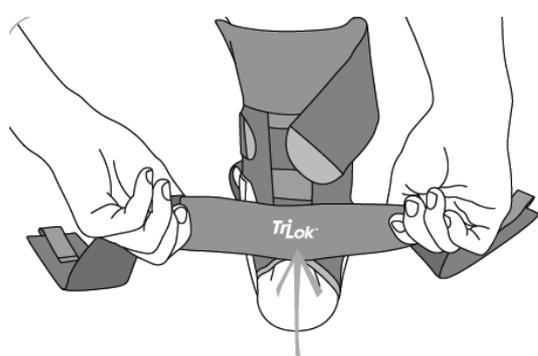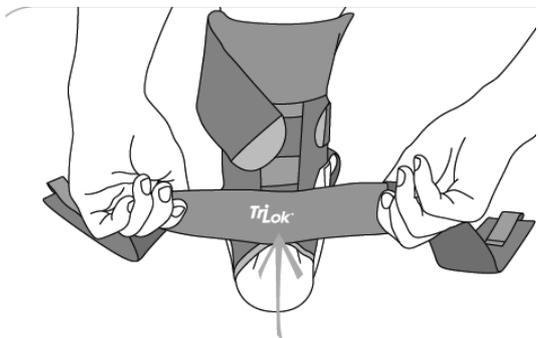

② 片側を足首の前側に巻きつけてから足の下に入れます。

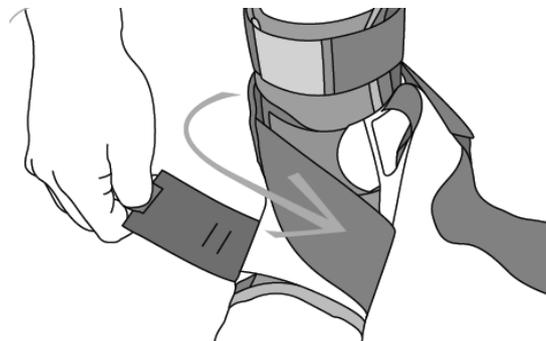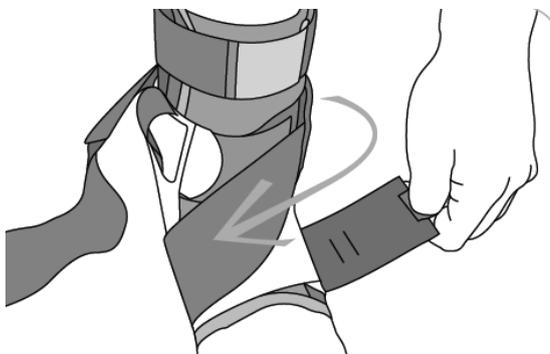

③ ストラップを上を引き上げ、足首の側面に高い位置に貼り付けます。反対側も②と③の手順を繰り返します。

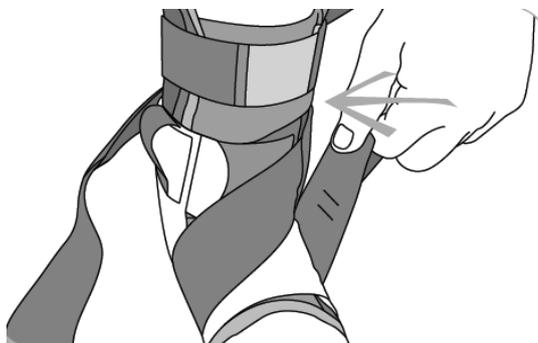

④ 最後にアンクルカラーを折り返して足首に巻きつけたら完了です。

