

ジャンボメディシンボールカバー

NISHI

取扱説明書

品番：NT5800

このたびは本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
なお、お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

⚠ 注意すること

○本品は、当社製品「ネモメディシンボール」を入れてトレーニングすることを前提として製作されています。それ以外の物を入れて使用しないでください。

⊘ してはいけないこと

- 本品に金属製の重量物を入れると、本品が破損するだけでなくケガなどの事故につながります。
- 本品を棒状の物で叩く、蹴る、引きずる、腰掛ける、壁面や支柱などにぶつけるなど過度に衝撃を与える行為はしないでください。
- コンクリートやアスファルト上での使用は避けてください。
- 高温、多湿、直射日光や雨の当たる場所に保管しないでください。
- 本品を積み重ねて保管すると、重量の影響で変形することがあります。
- 無理な重量でのご使用は避けてください。

❗ 必ず行うこと

- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて軽く拭き取って陰干ししてください。
- 十分なスペース（前後、左右、上部）を確保してご使用ください。トレーニング中、周りに人がいないことを確認してください。
- ご使用前に、外皮にほつれ、破れなどがいないか、ファスナーが正常に開閉できるか、内部ウレタンに摩耗や亀裂がないか確認し、異常があった場合は使用しないでください。

● その他

- 製造上、ウレタンに気泡が生じる場合がありますが、使用上影響はございませんのでご了承ください。

■ 廃棄について

本品の廃棄に関しては、地域で定める条例に従ってください。

■ はじめに

本品に直径19cmまたは24cmのネモメディシンボールを入れることで、直径35cmの大型でソフトなメディシンボールに変身し、ダイナミックな動きでトレーニングができるようになります。
また、内部に柔軟性の高いポリウレタンを採用し、メディシンボールそのものよりクッション性能が高まるように工夫しています。



■ 使用できるメディシンボール

本品の中に入れるメディシンボールは、下記品番に限ります。
直径29cm（NT5885C、NT5886C）のボールは使用できません。

ONT5881C	1kg	φ19cm	（サイズ調整用ウレタン使用）
ONT5882C	2kg	φ19cm	（サイズ調整用ウレタン使用）
ONT5883C	3kg	φ24cm	（サイズ調整用ウレタン不要）
ONT5884C	4kg	φ24cm	（サイズ調整用ウレタン不要）

■ 仕様

サイズ：（φ）350mm

重量：約1kg

材質：外皮/エラストマー

内部/ポリウレタン

付属品：サイズ調整用ウレタン

ファスナー開閉式

台湾製

※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。

お問い合わせ

商品には万全を期しておりますが、万一不具合やその他ご不明な点などございましたら、ご購入店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。
なお、輸送中に発生した異常や破損は賠償保険の対象になり、運送会社の証明が必要です。

株式会社ニシ・スポーツ お客様相談室

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目1番18号

TEL：03-6369-9024

受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

（土日、祝日及び弊社都合による休日を除く）

URL：<https://www.nishi.com/>

⚠️ 注意

取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷または、物的損害の発生が想定される危険があります。

○使用前に、ファスナーの持ち手がファスナーカバーの中に収納されているか確認してください。

持ち手がファスナーカバーから飛び出したまま使用すると、ケガをすることがあります。

○ファスナーに破損がないか確認し、破損が見受けられる場合は使用しないでください。

使用中に、内部にセットしたボールが飛び出すおそれがあります。

○ネモメディシンボールの汚れを落としてから中に入れるようにしてください。


○ネモメディシンボールをウレタンのくぼみに収め、ファスナーを完全に閉めてください。

閉まりきっていない場合は、ファスナーや外皮の破損につながります。



○ファスナーの持ち手は、ファスナーカバーの中に収納してください。

飛び出したままご使用になると、ファスナーが破損することがあります。

■ 各部の名称

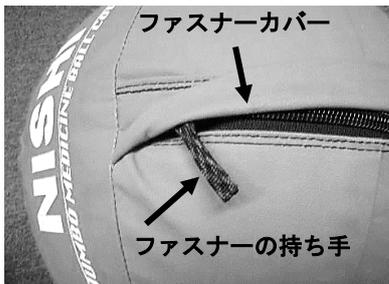

サイズ調整用
ウレタン

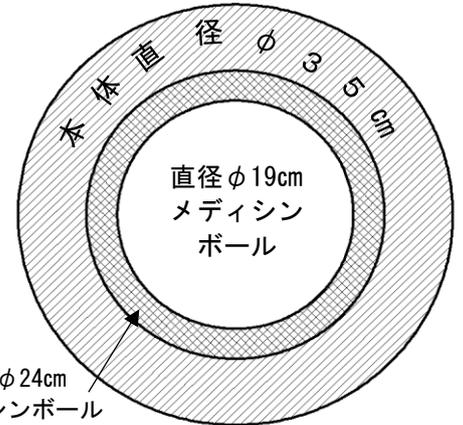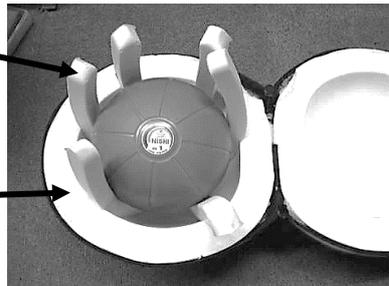

■ メディシンボールのセット方法

内部は直径24cmのボールを入れるように設計しています。付属のサイズ調整用ウレタンを使用すると、直径19cmのボールも使用できます。

①ファスナーカバーをめくり、ファスナーの持ち手を持ってファスナーをすべて開きます。

【図1】

⚠️ ファスナーを端まで勢いよく引きすぎると壊れる可能性がありますので、ご注意ください。

【図1】



②-1

直径19cmのメディシンボールを入れる場合は【図2】のとおり付属のサイズ調整用ウレタンの上にネモメディシンボールをセットしてください。


【図2】

②-2

次にサイズ調整用ウレタンでボールを包むようセットし、半球ウレタンをかぶせてファスナーを閉めます。

サイズ調整用
ウレタン

半球ウレタン

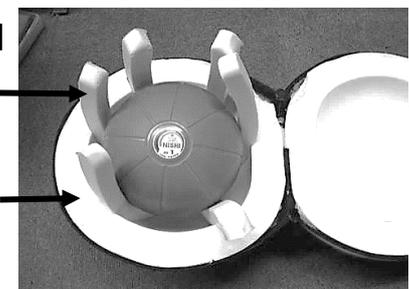

③直径24cmのネモメディシンボールを入れる場合は、サイズ調整用ウレタンは使用しません。【図3】

そのままボールを入れて半球ウレタンをかぶせ、ファスナーを閉めます。

【図3】

